

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn thời gian nộp báo giá

Gói cung cấp: Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải - NMNĐ Sơn Động

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Ngày 30/01/2026 Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV có Thư mời số 358/TM-NĐSD về việc mời khảo sát, báo giá gói cung cấp: Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải-NMNĐ Sơn Động.

Thư mời đã được đăng tải và thông báo rộng rãi trên Website của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (<https://vinacomin.vn/thong-tin-dau-thau.htm>) và Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (<https://www.dienluctkv.vn/>) ngày 30/01/2026.

Theo Thư mời số 358/TM-NĐSD ngày 30/01/2026 thì thời hạn nhà cung cấp nộp báo giá đến 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 02 năm 2026, tuy nhiên đến hết thời gian trên không có nhà cung cấp nào nộp báo giá. Vì vậy để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian khảo sát và chuẩn bị báo giá, Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo gia hạn thời gian nhận bản báo giá của Thư mời số 358/TM-NĐSD với nội dung như sau:

- Thời gian nhận báo giá theo Thư mời số 358/TM-NĐSD : Không chậm hơn 16 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026.

- Thời gian nhận báo giá được gia hạn: Không chậm hơn 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2026.

- Các nội dung khác trong Thư mời số 358/TM-NĐSD không thay đổi.


- Phụ lục đính kèm: Thư mời báo giá số 358/TM-NĐSD ngày 30/02/2026.

Vậy Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV thông báo đến các nhà cung cấp được biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐT.VT.

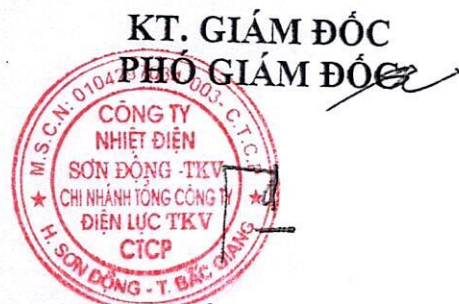

Vũ Hồng Chuyên

Số: 358 /TM-NĐSD

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải - NMNĐ Sơn Động

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải - NMNĐ Sơn Động.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải - NMNĐ Sơn Động với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói thầu

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải - NMNĐ Sơn Động

1.2. Nội dung thực hiện: Thay thiết bị phân tích khí thải tổ máy 1, thiết bị đo độ bụi tổ máy 2 của hệ thống quan trắc khí thải, thay đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra hệ thống quan trắc nước thải - NMNĐ Sơn Động. Nội dung và khối lượng công việc như Phương án số: 64/PA-KTAT ngày 27/01/2026 và phụ lục đính kèm thư mời.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh.

2. Năng lực tài chính: Nộp báo cáo tài chính 03 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế

3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức



- Năng lực nhân sự, máy móc
- Quy mô, mạng lưới khách hàng
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện

4. Các nội dung khác.

3. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yếu tố trượt giá và chi phí khác

4. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế hoặc tham khảo Phương án số: 64PA-KTAT ngày 27/01/2026.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com.


+ Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Ông Phạm Minh Đức - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư; Số điện thoại: 0963713352.

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: quyennb@vinacominpower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐT.VT.

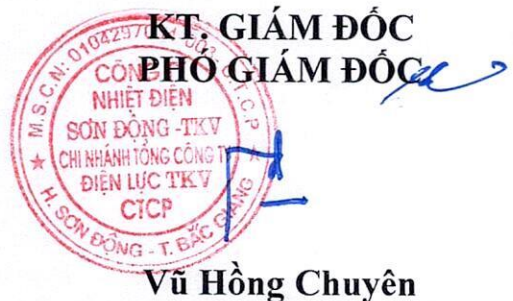

PHỤ LỤC: VẬT TƯ VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
(Đính kèm thư mời số **358**/TM-NĐSD ngày **30** tháng **01** năm **2026**)

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Vật tư mua mới						
1	Thiết bị đo độ bụi	- Phương pháp đo: Đo trực tiếp - Dải đo bụi: 0 -1000mg/m³ (tùy chỉnh) - Đơn vị đo: mg/m³ - Độ chính xác: % giá trị đọc tối thiểu: ± 5%; % khoảng đo tối thiểu: ± 5% - Độ phân giải: 0.1mg/m3 - Thời gian đáp ứng tối thiểu: ≤ 60 giây - Tín hiệu đầu ra: 4-20mA/RS485 - Cấp bảo vệ: IP65 - Làm sạch bằng khí nén.	Bộ	01			- Tương thích với hệ thống hiện hữu của nhà máy
2	Thiết bị phân tích đa chỉ tiêu (CO, SO ₂ , NO _x , O ₂)	- Sử dụng phương pháp đo trích mẫu gián tiếp (Extractive) - Sử dụng công nghệ trích mẫu lạnh khô (Cold-Dry) hoặc công nghệ trích mẫu nóng ẩm (Hot-Wet). - Sử dụng công nghệ đo phân tích các thành phần khí theo nguyên lý quang phổ hấp thụ hoặc nguyên lý điện hóa (công nghệ đo phân tích các thành phần khí phải đồng bộ với công nghệ trích mẫu). - Cấp bảo vệ: ≥IP54 - Thiết bị đo các chỉ tiêu khí CO, SO2, NOx, O2 phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật tại Bảng 5 Khoản 1 Điều 37 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT: + Đối với thông số CO: Dải đo: 0 - 6000 mg/Nm³ hoặc 0 - 6000ppm	Bộ	01			- Tương thích với hệ thống hiện hữu của nhà máy

Handwritten signature

	Đơn vị đo: mg/m ³ , ppm Độ chính xác % giá trị đọc tối thiểu: ± 5% % khoảng đo tối thiểu: ± 5% Độ phân giải tối thiểu: 1mg/m ³ ; 1 ppm Thời gian đáp ứng tối thiểu: ≤ 200 giây + Đối với thông số SO₂: Dải đo: 0 - 6000 mg/Nm ³ hoặc 0 - 6000ppm Đơn vị đo: mg/m ³ , ppm Độ chính xác: % giá trị đọc tối thiểu: ± 5% % khoảng đo tối thiểu: ± 5% Độ phân giải tối thiểu: mg/m ³ , 1 ppm Thời gian đáp ứng tối thiểu: ≤ 200 giây + Đối với thông số NOx: Dải đo: 0 - 6000 mg/Nm ³ hoặc 0 - 6000ppm Đơn vị đo: mg/m ³ , ppm Độ chính xác % giá trị đọc tối thiểu: ± 5% % khoảng đo tối thiểu: ± 5% Độ phân giải tối thiểu: 1 mg/m ³ , 1 ppm Thời gian đáp ứng tối thiểu: ≤ 200 giây + Đối với thông số O₂: Dải đo: 0-25% Đơn vị đo: %V Độ chính xác % giá trị đọc tối thiểu: ± 0,5% % khoảng đo tối thiểu: ± 0,5% Độ phân giải tối thiểu: 0,1%V Thời gian đáp ứng tối thiểu: ≤ 200 giây
--	---

Ula